


Anleitung zur schuhtechnischen Versorgung bei diabetischem Fußsyndrom

gemäß Nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes: Präventions- und Behandlungsstrategien für Fußkomplikationen



DDG ARBEITSGEMEINSCHAFT
Diabetischer Fuß

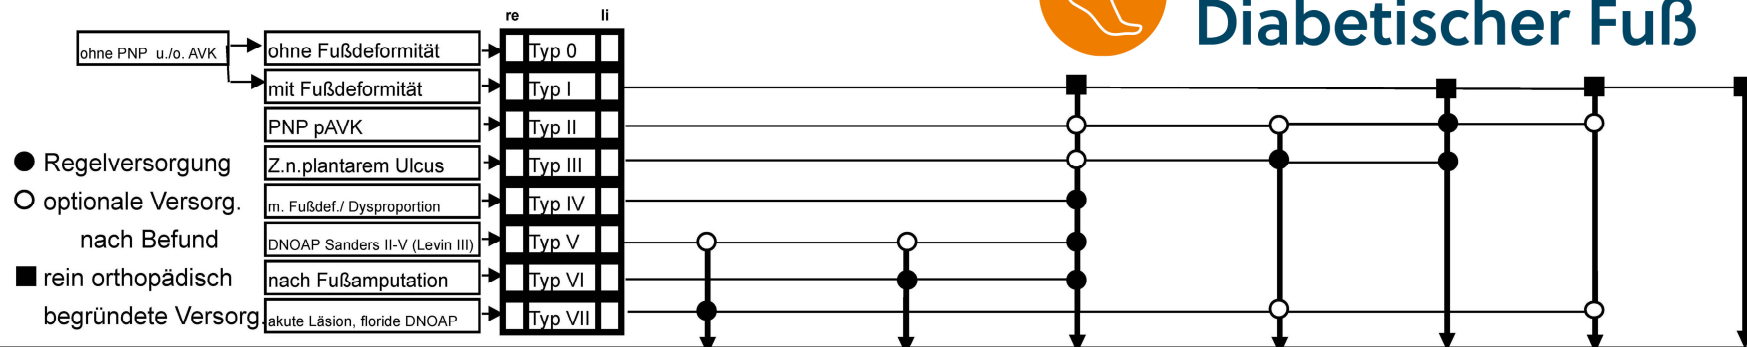

Kriterien für eine höhergradige Versorgung:		re	li	re	li	re	li	re	li	diab.Fußbett.	Schutzschuh	Zurichtungen	Einlagen
a) Kontralaterale Major-Amputation				TCC						Stck/Pair			
b) Arthropathie Hüfte / Knie / OSG oder Gelenkimplantat mit Funktionsbeeinträchtigung / Kontraktur				Interims-schuhe PG31		Innenschuh		1Paar hohe orth. Schuhe		Individuell gefert. Diabetesadapt. Fußbettung, ca. 8mm stark, tiefgezogen über individuell hergestelltem Fußmodell, und in den Schuh eingepaßt	Ballenrolle Mittelfußrolle Zehenrolle	Ballenrolle Mittelfußrolle Zehenrolle	nach Maß und Formabdruck handwerkli. gefertigt
c) Amputation der Großzehe / Resektion MFK I				Vorfußentlast.-orthese		Zehenersatzprothese		Gehprobemodell					Schaleneinlagen
d) Motorische Funktionseinschränkung / Parese eines oder beider Beine				Fersenentlast.-orthese		Vorfußersatzprothese mit spezieller Stumpfkonturbettung		Fußbettung Diabetesadaptiert					Gewölbestützen
e) Höhergradige Gang- und Standunsicherheit				Einschalen-unterschenkel-orthese n.Maß				Schaftpolster					Polster 3/4
f) Extreme Adipositas (BMI ≥ 35)				Rahmenorthese nach Maß				gewalkte Knöchel-wadenpolster					
g) Dialysepflichtige Niereninsuffizienz											Weichbett-abroller	Weichbett-abroller	langsohlig
h) Beruf mit überwiegender Steh- und Gehbelastung													Bettungseinlagen
i) Erhebliche Visuseinschränkung													
j) Fehlgeschlagene adäquate Vorversorgung													
k) Höhergradige Deformität													
Patientendaten	sonst. orthopädischer Befund:							Abrollpufferabsatz		Ausarbeitung und Polsterung der Entlastungszone			Vorfußpolster
			Zweischalen-unterschenkel-orthose n. Maß			Orthesen		Diabetesfutter			Voreitofung der Sohle	Voreitofung der Sohlen	Fersenpolster
			Verbandschuhe					Sohlenabroller			Absatzrolle	Absatzrolle	Entlastungspolster
								Walklasche					
								Sohlenversteifung					
			Diabetic Walker					Arthrosenkappe		Stck/Pair DAF	Pufferabsatz	Pufferabsatz	
			Maß-Bal-Schuh					Lähmungskappe		mit Ulcus-einbettung	Schaftweitung	Schaftweitung	
								Verstärkungen			Schaftänderung	Schaftänderung	
								Abformung			nach Kalkulation	nach Kalkulation	
								Leistenarbeiten					
MRSA				Druckmessung		Druckmessung		Druckmessung		Druckmessung			Sondereinlage

Zusätzliche, für die Versorgung relevante Diagnosen:

akt. Stand 23.03.08 © mod.m.Erl.AG-Fuß ADE

Unterschrift OT/OSM:

Unterschrift Verordner:

Datum:

Vertragsarztstempel